

**SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.**

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9

centrala: (32) 228 30 30

sekretariat: (32) 228 23 47

fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 07.06.2019 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/340/15/2019

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 89, poz. 2

Biorąc udział w przedmiotowym postępowaniu, w związku z udzielonymi w dniu 04.06.2019. odpowiedziami na pytania, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W odpowiedzi na pytanie nr 28 Zamawiający dopuszcza również ładunek 60mm do tkanki bardzo grubej (wysokość zamkniętej zszywki 2,3mm). Pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku ładunków dostarczone rozwiązanie musi uwzględniać swoistą budowę tkanki, złożonej z elementów stałych (mięśnie, błona surowicza) jak i płynnych (krew, limfa, woda), a także zapewniać jednolite formowanie zszywek na całej długości linii zespolenia, właściwe do różnych rodzajów tkanek, w celu uzyskania dobrej hemostazy. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o uściślenie czy w Pakiecie 89 w Pozycji 2 Zamawiający będzie wymagał ładowanych w szczelki staplera ładunków przeznaczonych do tkanki naczyniowej cienkiej (wysokość zamkniętej zszywki 0,75mm), naczyniowej (wysokość zamkniętej zszywki 1,0mm), normalnej (wysokość zamkniętej zszywki 1,5mm), średnio grubej (wysokość zamkniętej zszywki 1,8mm), grubej (wysokość zamkniętej zszywki 2,0mm) i bardzo grubej (wysokość zamkniętej zszywki 2,3mm, ładunek z powierzchnią przytrzymującą tkankę)?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania ładunków do staplerów o parametrach opisanych w pytaniu, jednocześnie modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 – Pakiet nr 89

Pytanie nr 2 – Pakiet nr 89, poz. 1

Biorąc udział w przedmiotowym postępowaniu, w związku z udzielonymi w dniu 04.06.2019. odpowiedziami na pytania, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W odpowiedzi na pytanie nr 27 Zamawiający dopuszcza uniwersalną jednorazową rękojeść staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego. Pragniemy zwrócić uwagę, że dostarczone rozwiązanie w przypadku artykulacji musi uwzględnić naturalną artykulację, umożliwiającą chirurgowi skoncentrowanie się na linii cięcia oraz pozycjonowaniu kowadła dokładnie w pożądanym miejscu. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o uściślenie czy oferowane w Pakiecie 89 w Pozycji 1 rozwiązanie ma być mechanicznym staplerem tnącym z wbudowaną w instrument naturalną artykulacją, który można obsługiwać jedną ręką, co pozwala wyeliminować niedokładność artykulacji w porównaniu z tradycyjnymi endoskopowymi staplerami tnącymi, działającymi w oparciu o dodatkową dźwignię, obsługiwanymi dwiema rękoma?

NIP 6431764082 REGON 000308270

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS Nr 0000490160,
Kapitał zakładowy 26 548 000,00 zł,

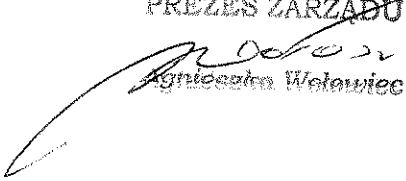
ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania staplera o parametrze opisanym w pytaniu – mechaniczny stapler tnący z wbudowaną w instrument naturalną artykulacją, , jednocześnie modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 – Pakiet nr 89

Zgodnie z zapisem art.38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 27.06.2019 r. do godz. 9:30 oraz termin otwarcia ofert na dzień 27.06.2019 r. godz. 11:00. Jednocześnie ulega zmianie termin wniesienia wadium i ważności wadium.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


Agnieszka Wołowicz

